

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пущин



2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия  
«Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант"  
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014»

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) в развернутом виде



Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) в развернутом виде




Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) в развернутом виде



Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) в развернутом виде




Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) крупным планом

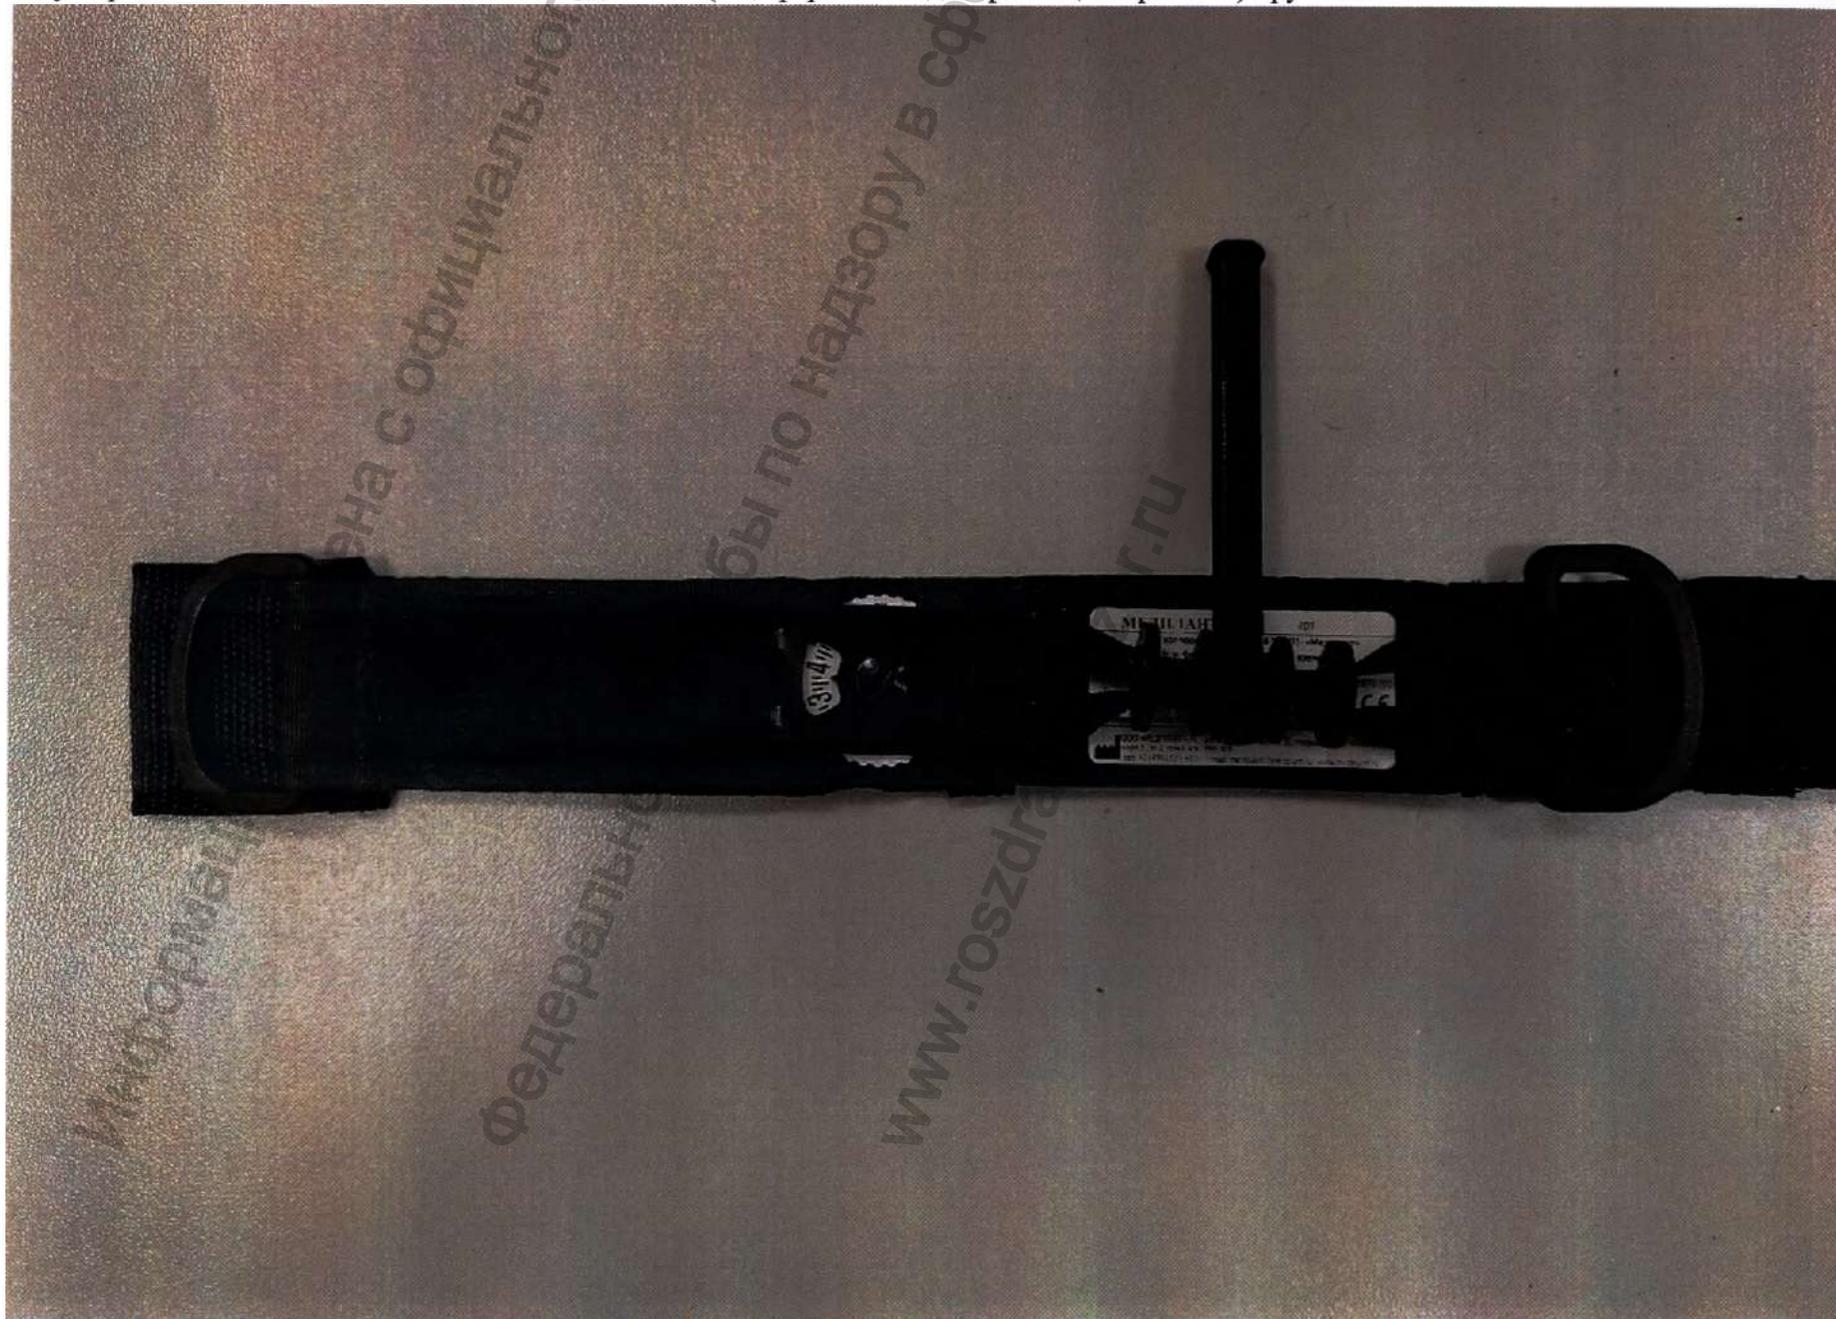

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) крупным планом



Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) крупным планом

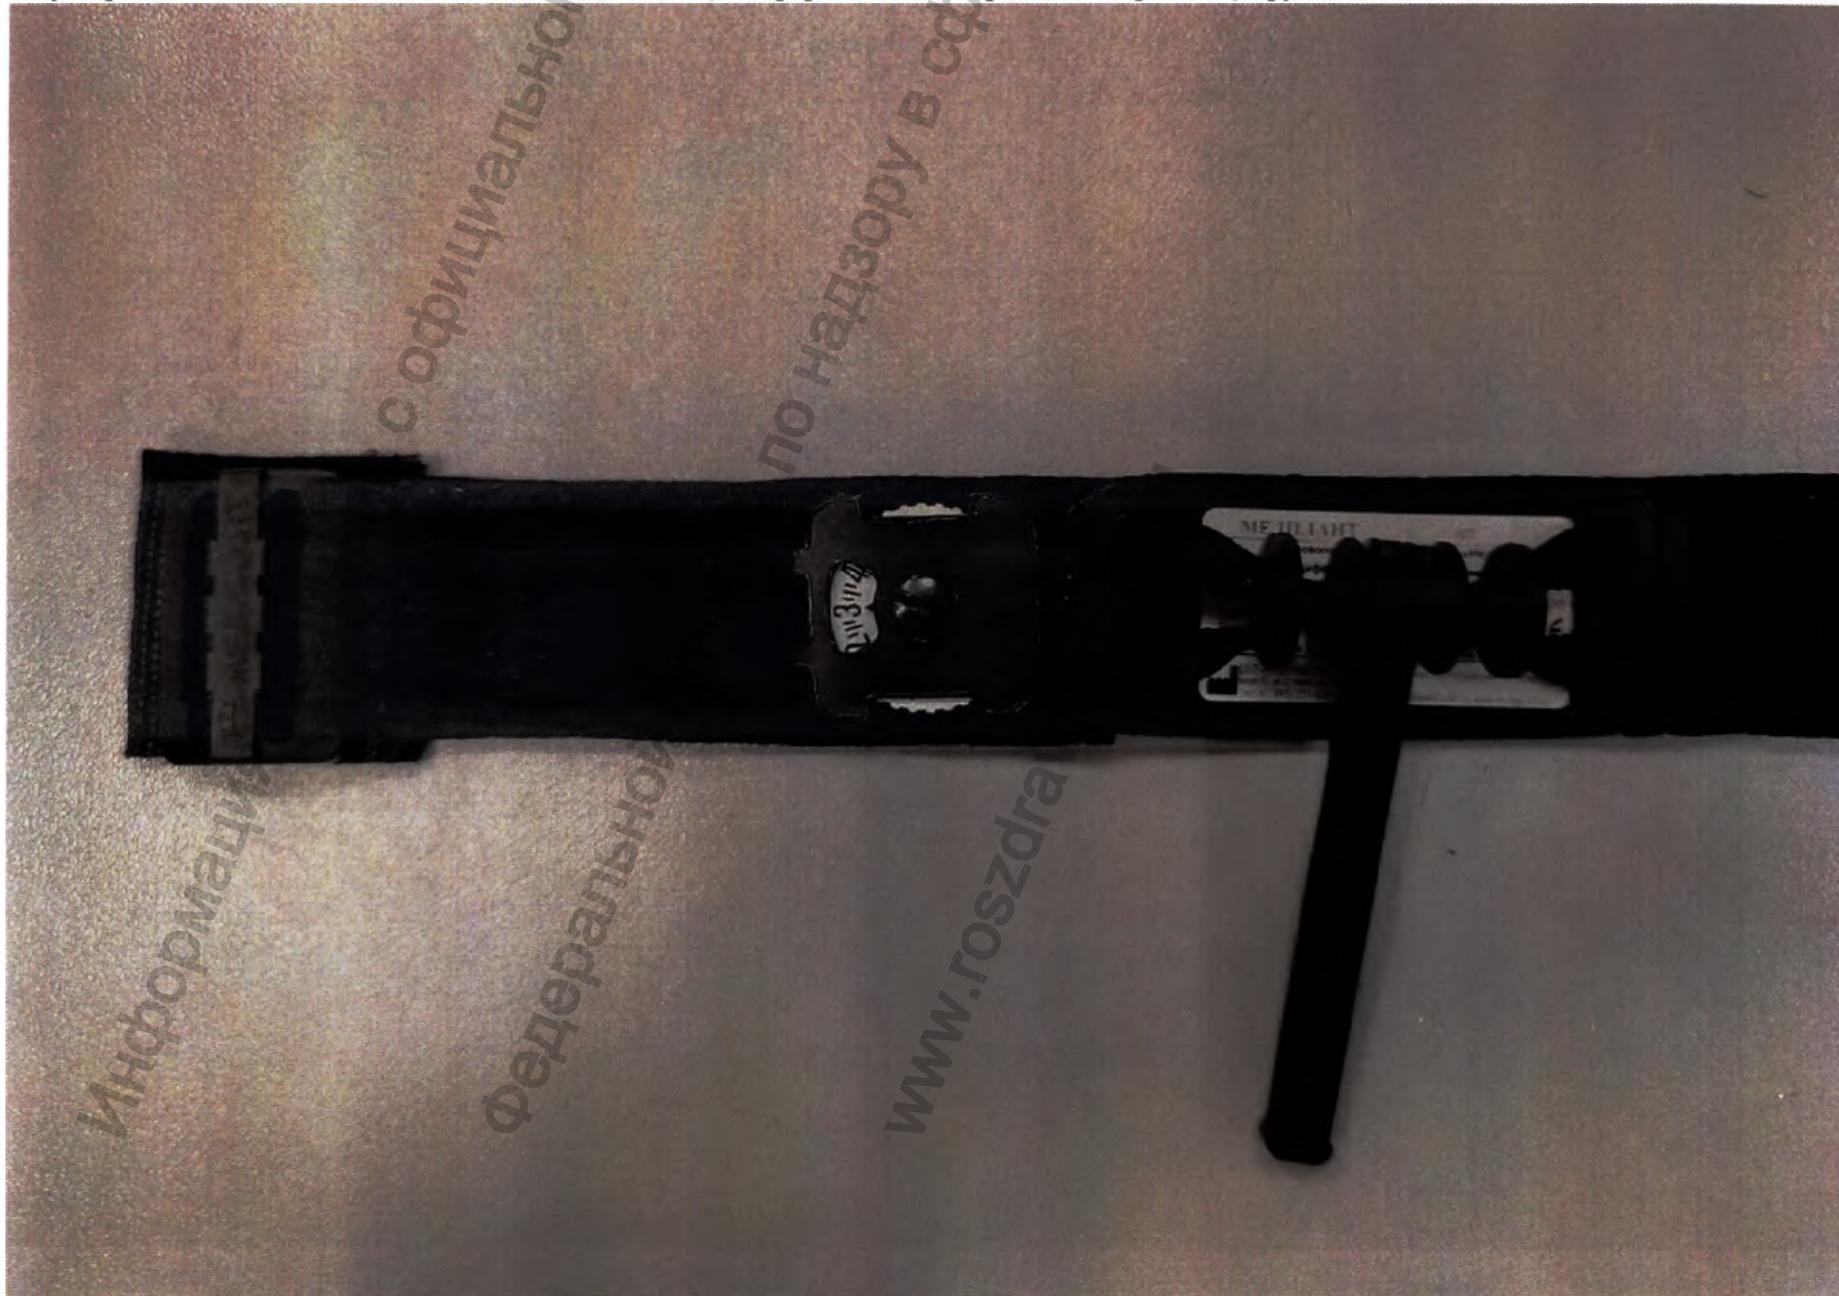


Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медшлант» (с лентой для фиксации времени) крупным планом



Общий вид в упаковке и маркировка

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 1

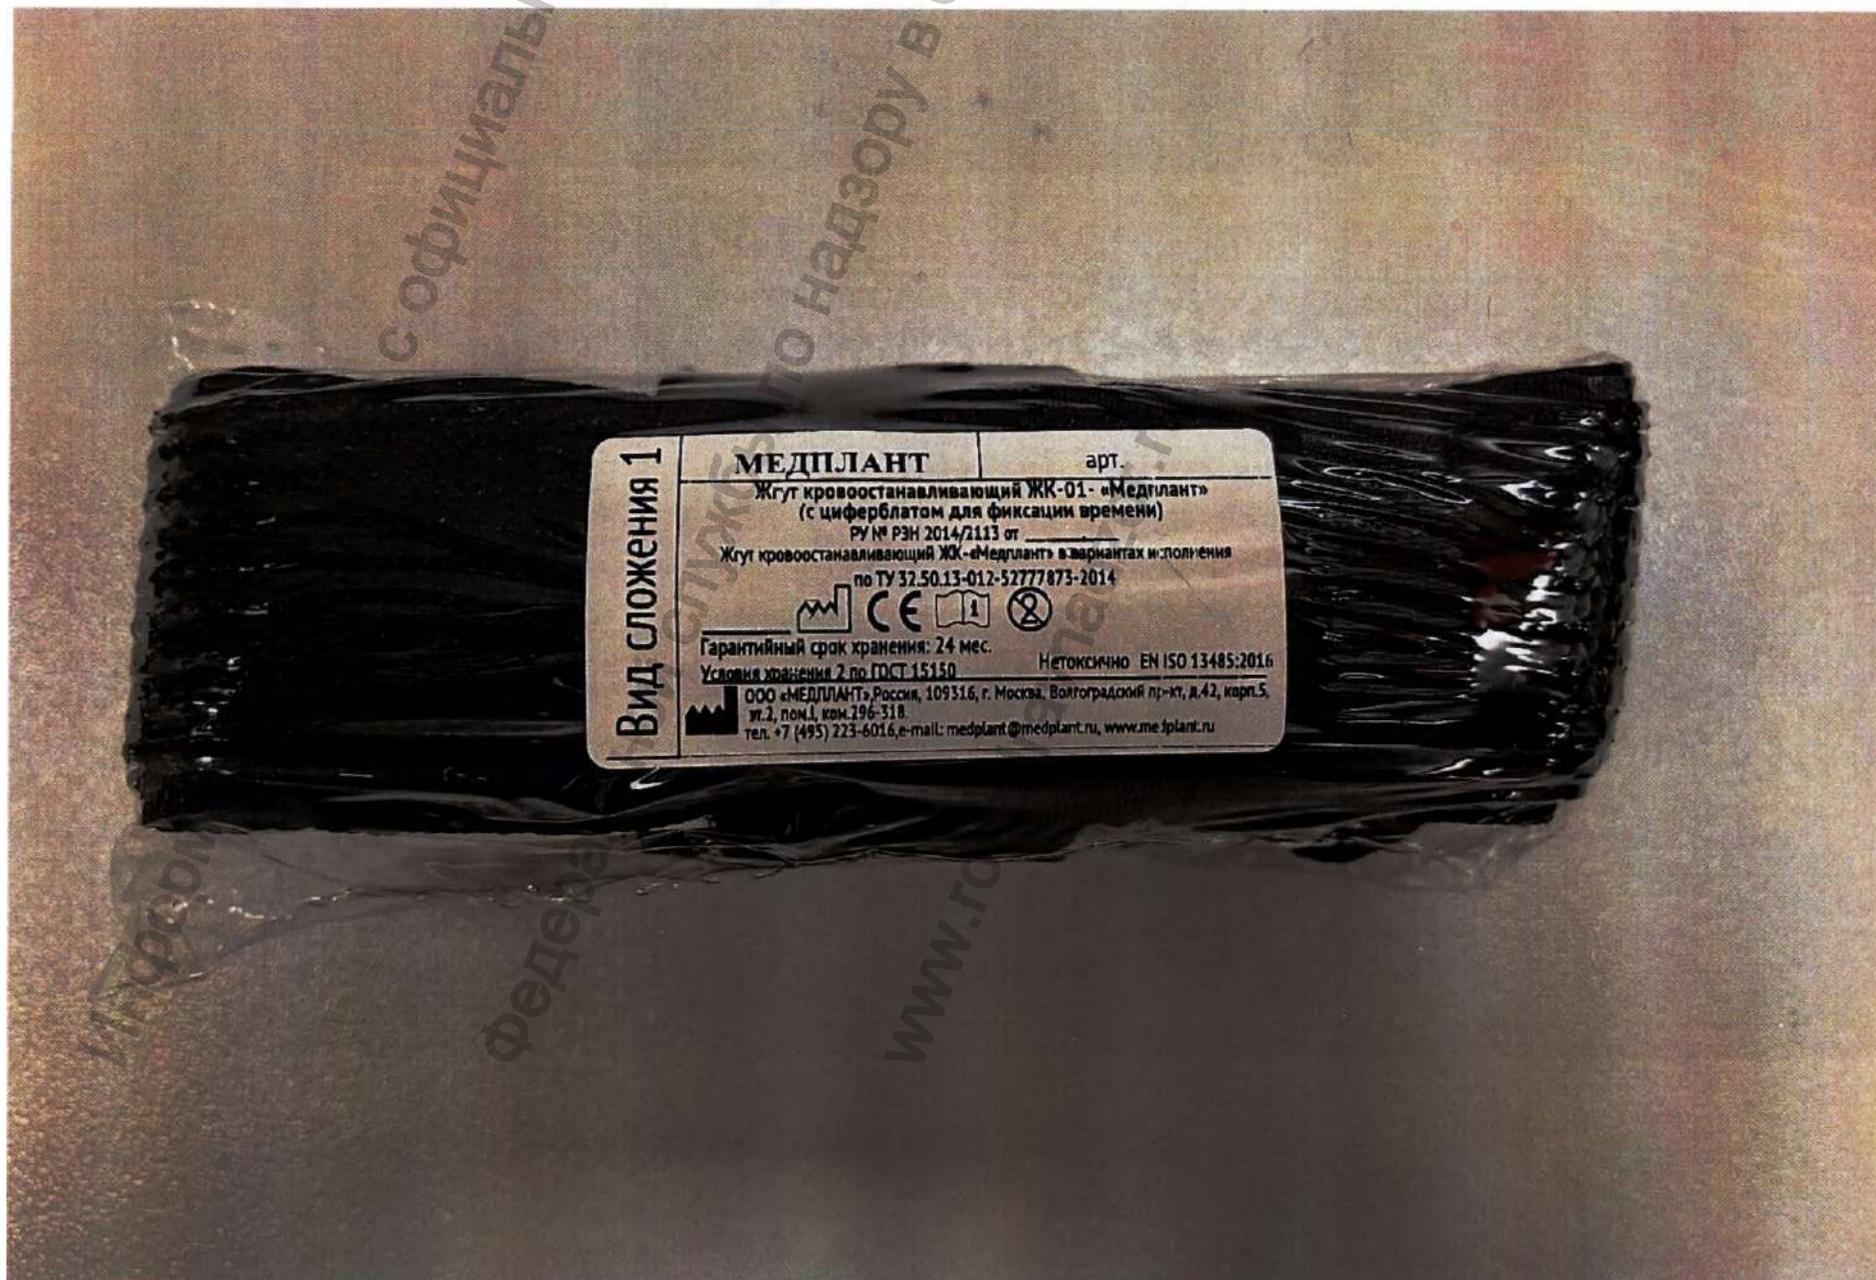

# Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

Р/ч № РЭН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах и исполнениях  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр.-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, кон.296-318.

Тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.gmc-plant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 2



Вид сложения 2


**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

РУ № РЭН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский п-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)**

РУ № РЭН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения**

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени), вид сложения 1



Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2014

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени), вид сложения 2




Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)  
РУМ РЭН 2014/2113 от  
Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.      Нетоксично EN ISO 13485:2016  
Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

ООО «МЕДПЛАНТ» Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, комн.296-318.  
Тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014**



**Гарантийный срок хранения: 24 мес.**

**Условия хранения 2 по ГОСТ 15150**


**Нетоксично EN ISO 13485:2016**



**ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.**

**тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru**

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 1

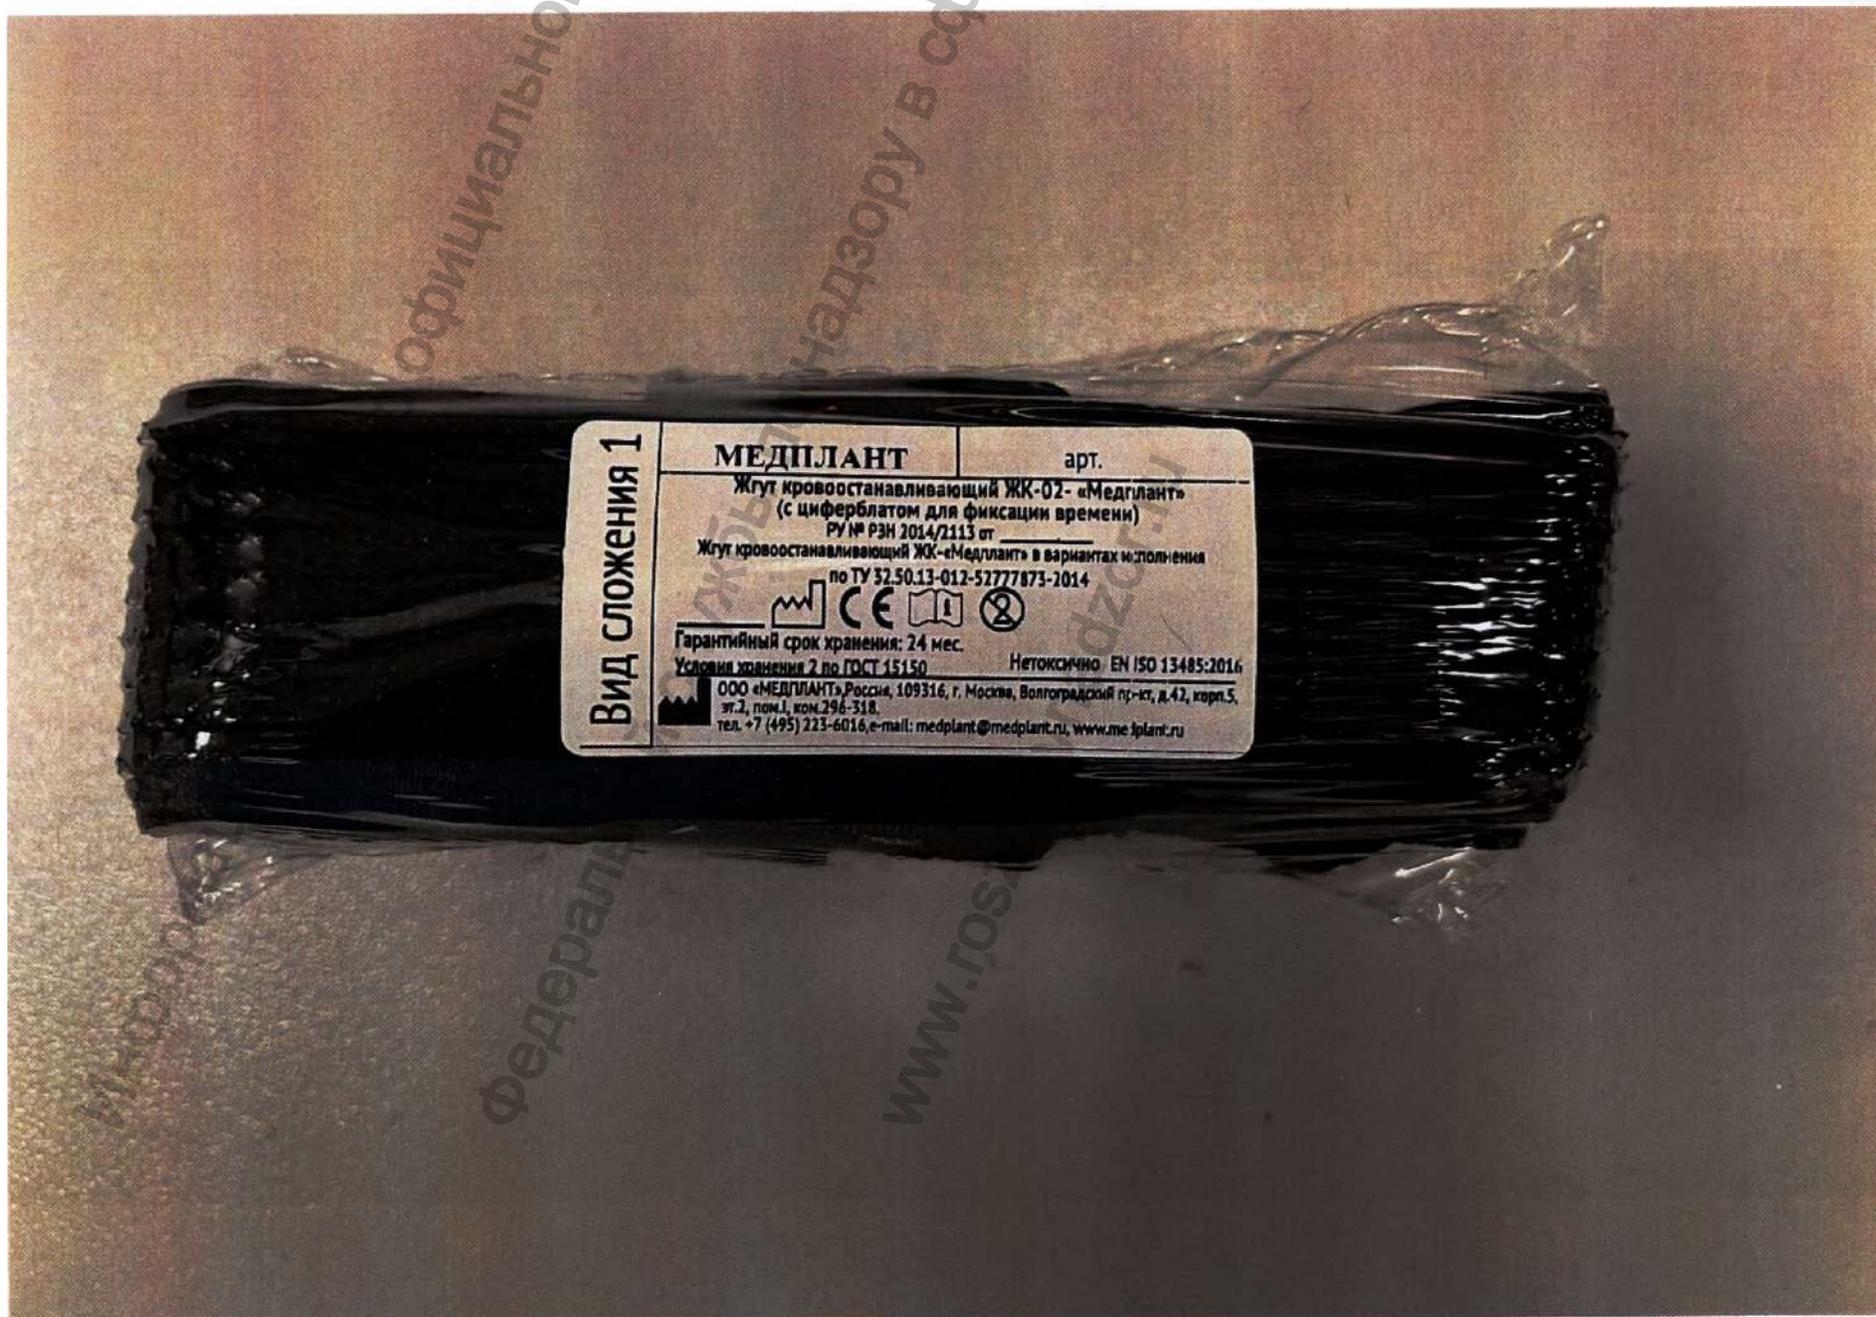

Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016

ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени), вид сложения 2



Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с циферблатом для фиксации времени)

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150


Нетоксично EN ISO 13485:2016



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени), вид сложения 1

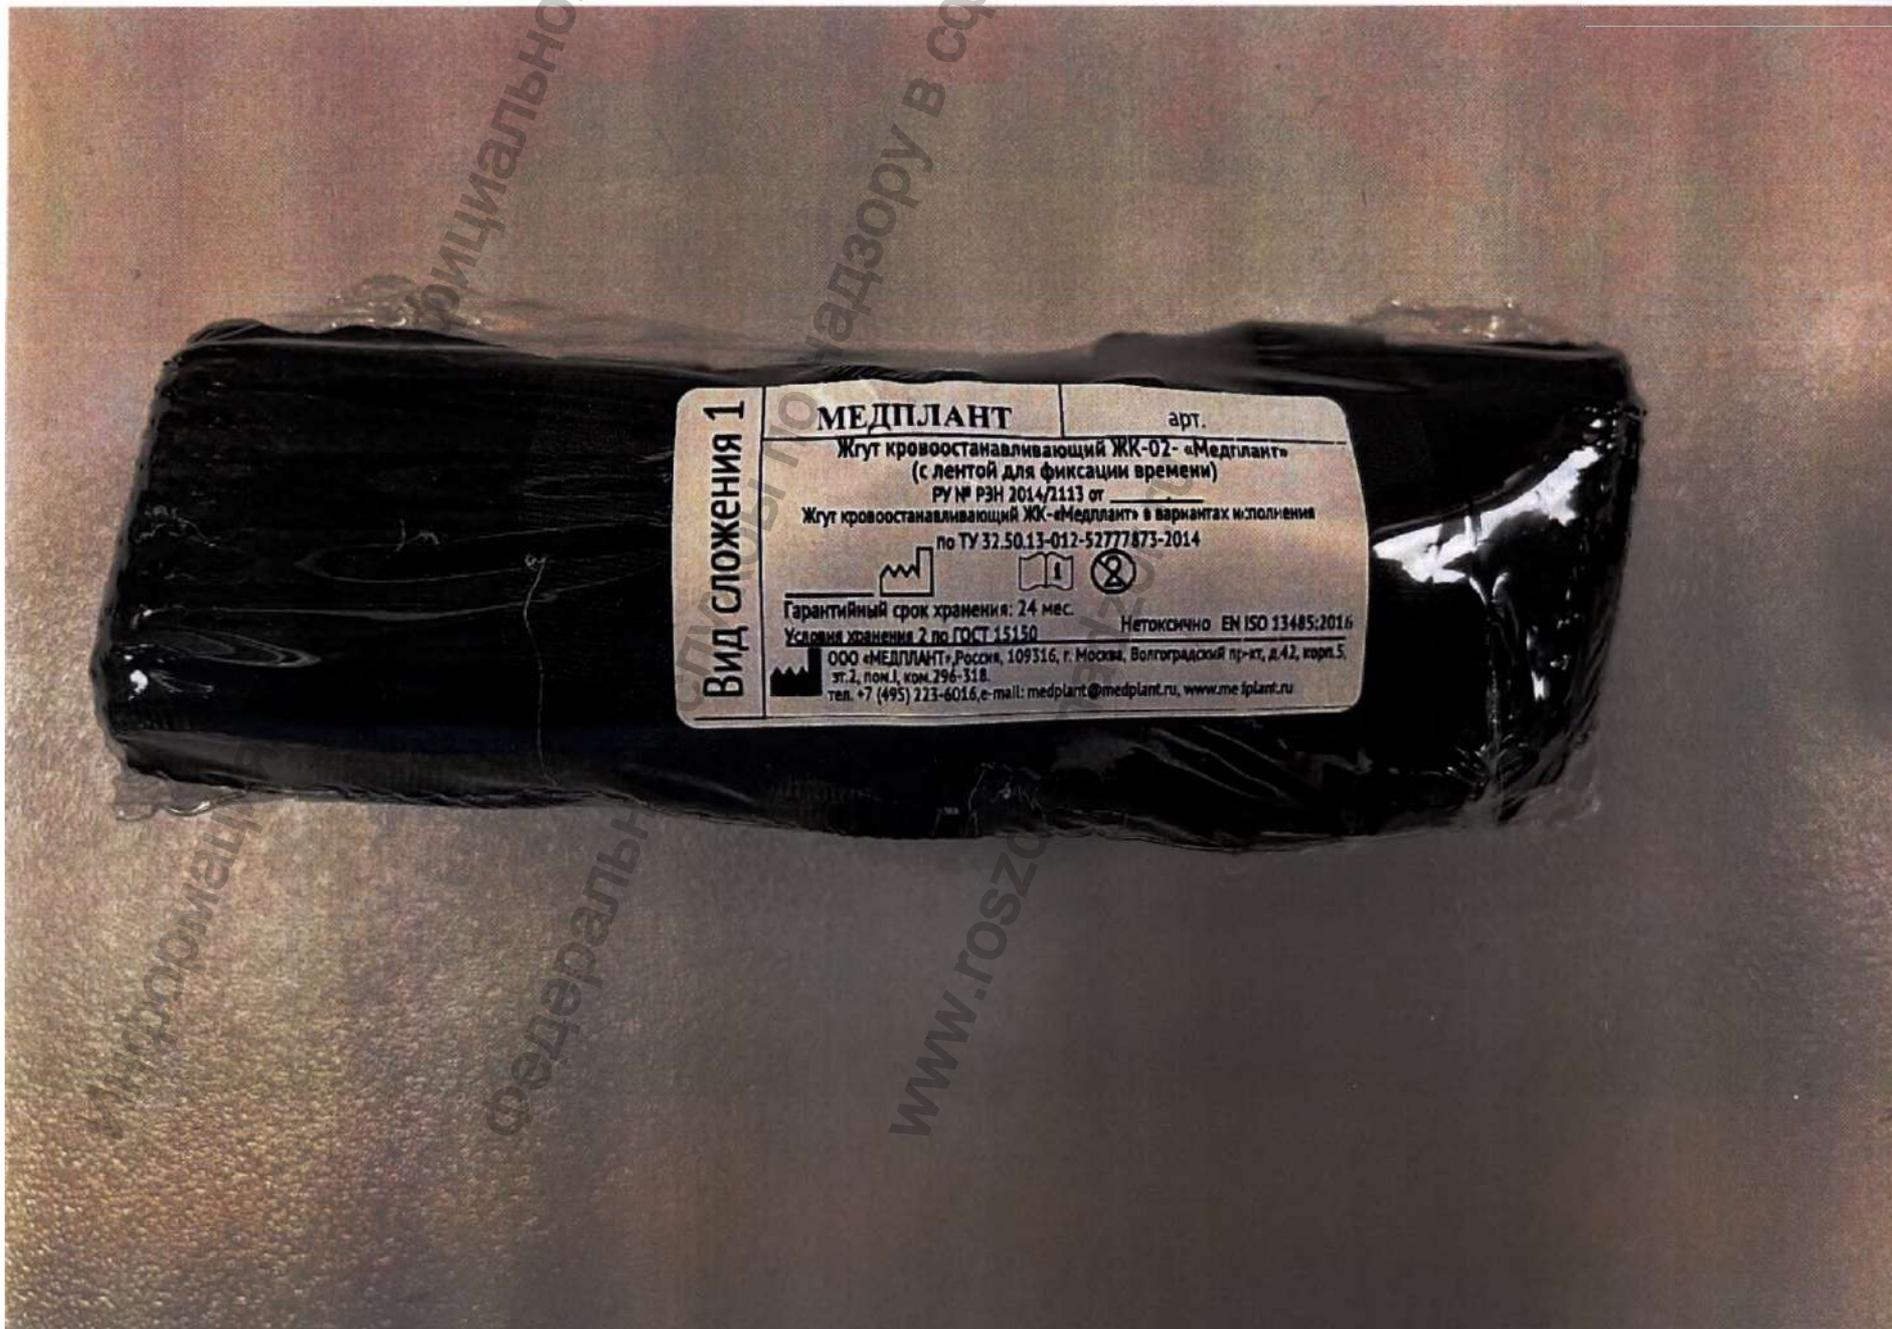

Вид сложения 1

**МЕДПЛАНТ**

арт.

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)**

РУ № РЗН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

**Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения  
по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014**



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Нетоксично EN ISO 13485:2016

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.  
тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени), вид сложения 2



Вид сложения 2

**МЕДПЛАНТ**

арт.

Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»  
(с лентой для фиксации времени)

РУ № РЭН 2014/2113 от \_\_\_\_\_

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014



Гарантийный срок хранения: 24 мес.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

Нетоксично EN ISO 13485:2016



ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пер.-кт, д.42, корп.5,  
эт.2, пом.1, ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
| Вид сложения 1 | <p><b>МЕДПЛАНТ</b> арт. _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант»</b> в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>   </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 <span style="float: right;">Нетоксично EN ISO 13485:2016</span></p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> | Вид сложения 2 | <p><b>МЕДПЛАНТ</b> арт. _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант»</b> в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>   </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 <span style="float: right;">Нетоксично EN ISO 13485:2016</span></p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> |
|                | <p><b>МЕДПЛАНТ</b> арт. _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант»</b> в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>  </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 <span style="float: right;">Нетоксично EN ISO 13485:2016</span></p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>  |                | <p><b>МЕДПЛАНТ</b> арт. _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант»</b> в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>  </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 <span style="float: right;">Нетоксично EN ISO 13485:2016</span></p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>  |

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| <b>Вид сложения 1</b> | <b>МЕДПЛАНТ</b>  | арт. |
|                       | <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>   </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> |      |

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| <b>Вид сложения 2</b> | <b>МЕДПЛАНТ</b>  | арт. |
|                       | <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>   </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> |      |

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| <b>Вид сложения 1</b> | <b>МЕДПЛАНТ</b>  | арт. |
|                       | <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>  </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> |      |

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| <b>Вид сложения 2</b> | <b>МЕДПЛАНТ</b>  | арт. |
|                       | <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>  </p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.<br/>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p> <p> ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,<br/>эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p> |      |

| МЕДПЛАНТ  | арт. |
|---|------|
| <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>Год выпуска: _____</p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.</p> <p>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> |      |
|    <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p>  |      |
|  <p>ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>   |      |


| МЕДПЛАНТ   | арт. |
|--|------|
| <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-01- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>Год выпуска: _____</p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.</p> <p>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> |      |
|   <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p>  |      |
|  <p>ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>  |      |

| МЕДПЛАНТ  | арт. |
|---|------|
| <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с циферблатом для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>Год выпуска: _____</p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.</p> <p>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> |      |
|    <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p>  |      |
|  <p>ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>   |      |

| МЕДПЛАНТ   | арт. |
|--|------|
| <p><b>Жгут кровоостанавливающий ЖК-02- «Медплант»</b><br/>(с лентой для фиксации времени)<br/>РУ № РЗН 2014/2113 от _____</p> <p>Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант» в вариантах исполнения<br/>по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014</p> <p>Год выпуска: _____</p> <p>Гарантийный срок хранения: 24 мес.</p> <p>Условия хранения 2 по ГОСТ 15150</p> |      |
|   <p>Нетоксично EN ISO 13485:2016</p>  |      |
|  <p>ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.<br/>тел. +7 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru</p>  |      |

Общий вид изделия в сложенном виде, эксплуатационная документация вложена внутрь

Руководство по эксплуатации

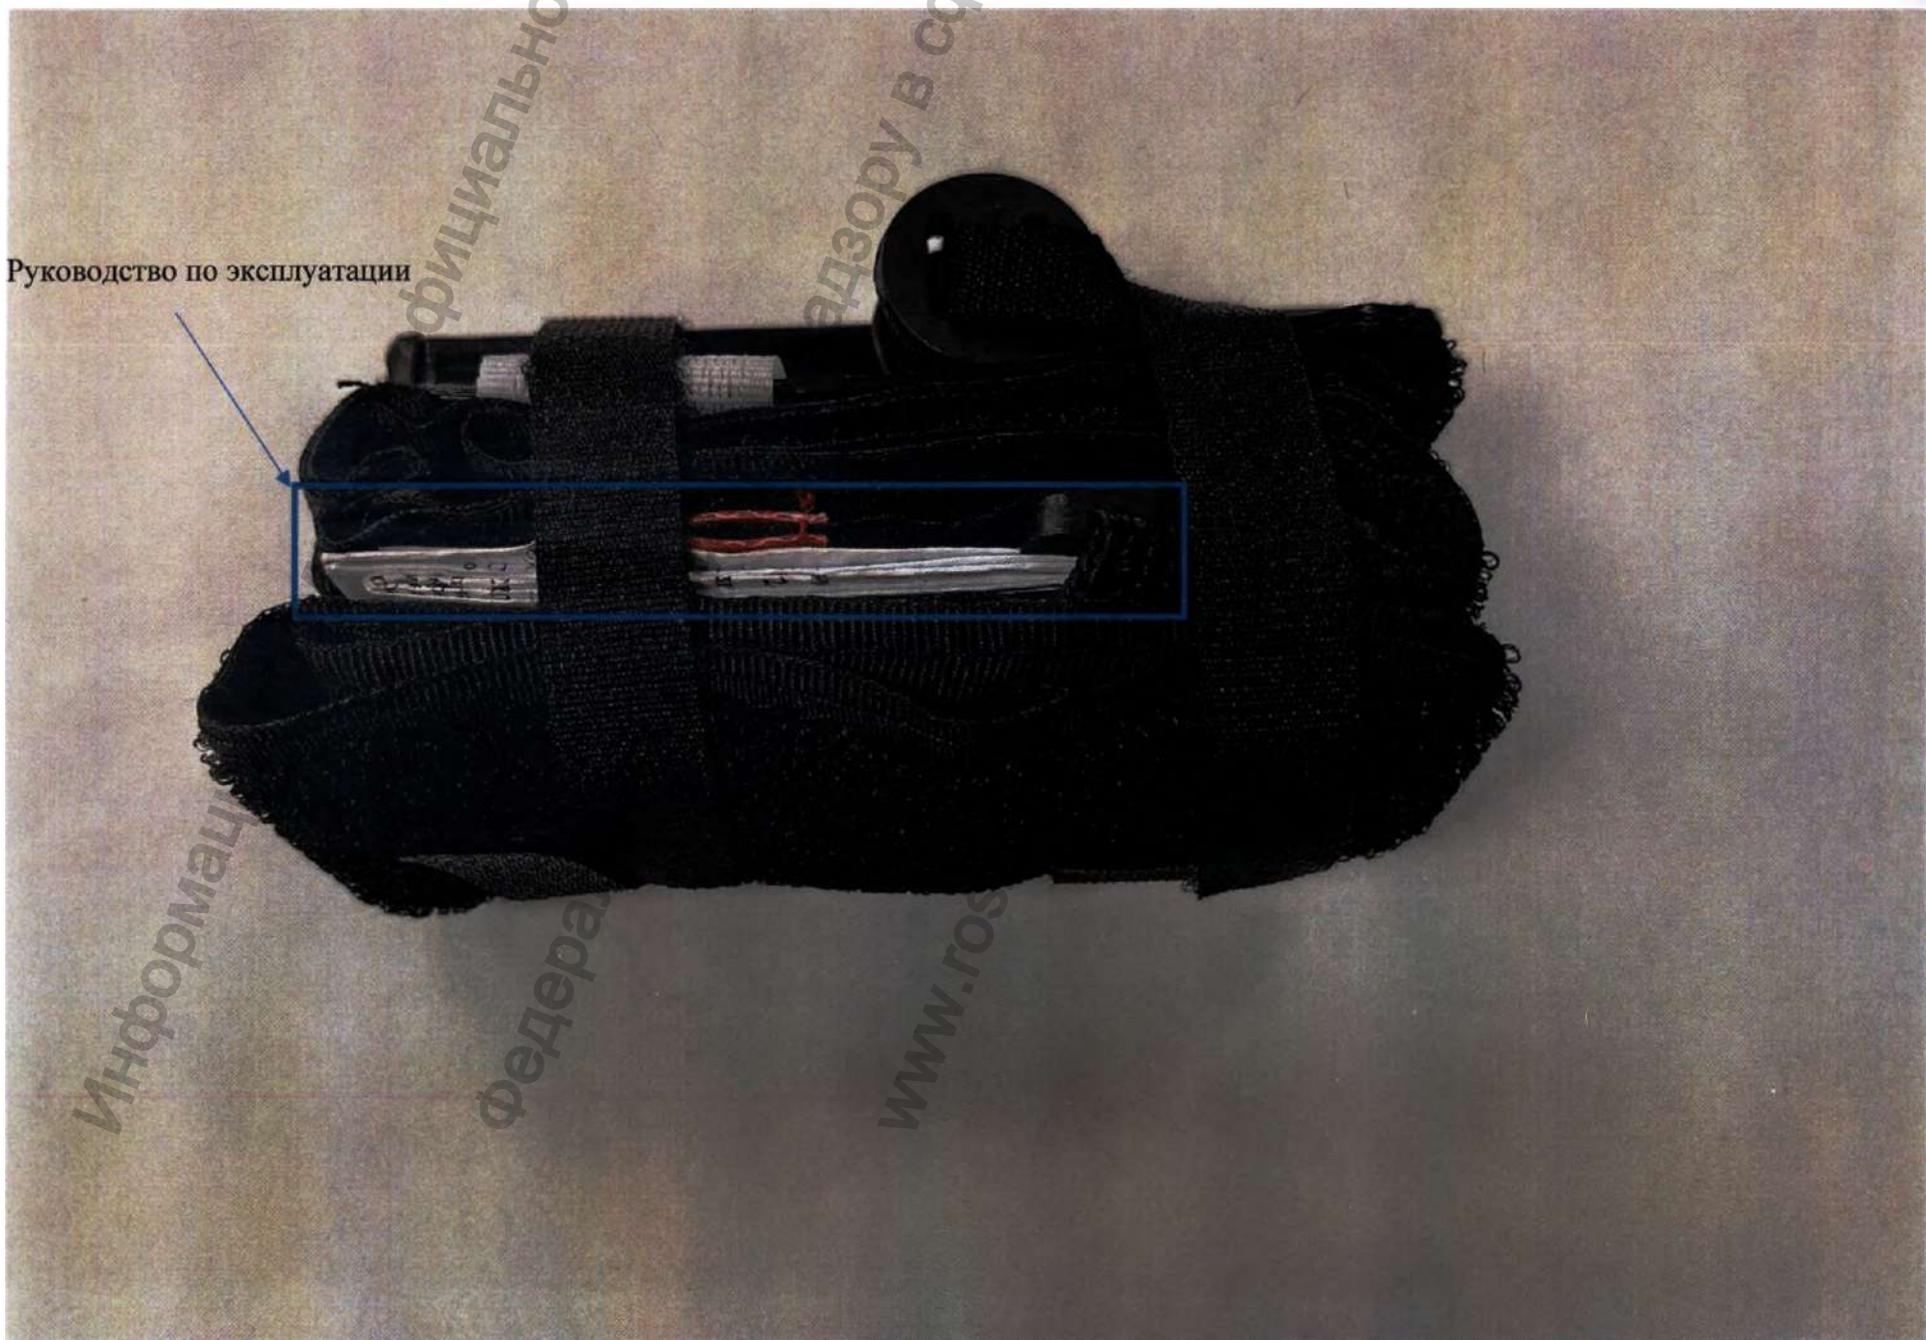

Общий вид изделия в упаковке, эксплуатационная документация вложена внутрь



всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 28

цифрами

двадцать

по описью

) листов

Васильев  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ПУШИН/А.В.

должность, ФИО

подпись



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)